

# 患者さんと一緒に 保守点検を実施しましよう

血糖自己測定器は特定保守管理医療機器<sup>\*</sup>です。下記のツールを活用して、患者さんにも血糖自己測定器の保守点検に参加してもらいましょう


## 使用開始シール

血糖自己測定器の使用期間を把握することは大切なことです。使用開始シールを機器に貼付し、保守点検や交換の時期の管理に活用しましょう。機器に合ったシールは各メーカーよりお取り寄せ頂けます。また耐用期間<sup>\*</sup>を目安に機器の交換を検討しましょう。



## 自己管理ノート

日本糖尿病協会発行の自己管理ノートには、患者さんに確認いただく日常の保守点検についての記載があります。患者さんと一緒に日々の点検チェックポイントについて確認しましょう。

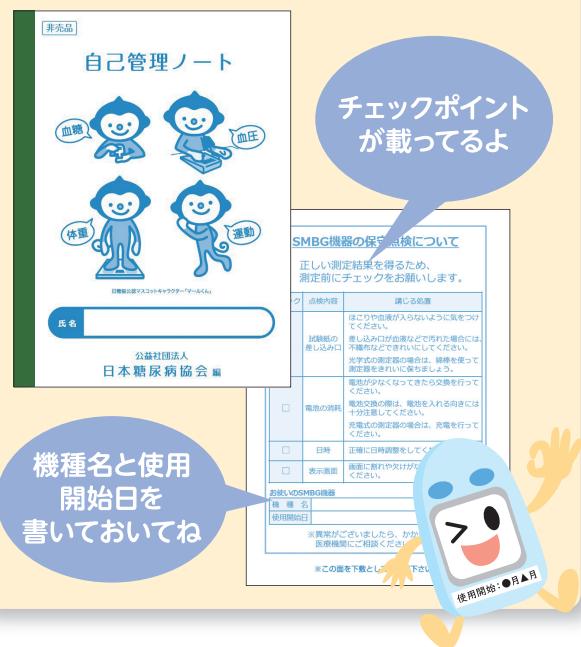

日本糖尿病協会では血糖自己測定器の適正使用を推進しています。  
血糖自己測定器販売各社への問い合わせ窓口は、裏面をご覧ください。

\*特定保守管理医療機器とは、適正な管理が行われなければ重大な影響が出る恐れがあるものとして厚生労働大臣が指定したものです。医療機関には、特定保守管理医療機器の保守点検に関する計画の策定やその実施が義務付けられています。



公益社団法人 日本糖尿病協会

お問い合わせ先

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-2-4 麹町セントラルビル 8F  
TEL.03-3514-1721 FAX.03-3514-1725

### 情報提供ページ

日本糖尿病協会  
糖尿病医薬品・医療機器等適正化委員会

血糖自己測定器の適正使用をはじめ、  
患者さんのための適正な糖尿病医療に  
向けた取組みを行っています。

